Баллонная стойка для двух 40 (50) л. баллонов

(пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)

Паспорт

ТДМ.ТДМ-СБМП-02 ПС

ООО "Технодизайн-М"
Образец

Содержание

1. Общие указания. 2

2. Основные сведения об изделии и технические данные. 2

3. Комплектность. 2

4. Монтаж изделия. 3

5. Установка баллонов. 3

6. Упаковка и транспортирование. 3

7. Гарантии изготовителя. 3

8. Сведения об утилизации. 3

9. Сведения о предприятии-изготовителе. 4

10. Свидетельство о приёмке. 5

11. Особые отметки. 5

Приложение А. 6

ООО "Технодизайн-М"
Образец

1. Общие указания.

Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт должны проводиться с учётом мер предосторожности и факторов опасности для жизни и здоровья человека.

В случае передачи изделия другому потребителю настоящий паспорт и документация, указанная в разделе «Комплектность» подлежит передаче вместе с изделием.

Все записи в паспорте должны производиться чернилами, отчётливо и аккуратно. Записи, вносимые в паспорт, должны быть заверены подписью. Исправления, незаверенные подписью, не допускаются.

2. Основные сведения об изделии и технические данные.

Изделие представляет собой баллонную стойку, предназначенную для установки на ней 2 баллонов с газами различного назначения. Модель стойки – ТДМ-СБМП-02[1].

Дополнительно на стойку может быть установлен универсальный баллонный адаптер для баллонов от 5л до 10л ТДМ-АБУ-5-10. Баллонный адаптер ТДМ-АБУ-5-10 заказывается отдельно.

В верхней части стойки предусмотрена монтажная панель, предназначенная для размещения на ней газораспределительного оборудования.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики установки.

№	Наименование	Ед.изм	Значение
1	**2**	**3**	**4**
1.	Габаритные размеры ВхШхГ	мм	1800х700х650
2.	Масса стойки не более	кг	25
3.	Конструкция		Металлоконструкция из монтажного профиля, оцинкованная сталь, толщина - 1.5 мм
	Характеристики устанавливаемых баллонов		
4.	Количество баллонов	шт	2
5.	Емкость одного баллона	л	40, 50
6.	Диаметр одного баллона	мм	219-230

Габаритный чертеж изделия представлен в приложении А.

3. Комплектность.

- Баллонная стойка, модель ТДМ-СБМП-02 (исполнение см. в разделе «Свидетельство о приемке») – 1 шт.;
- Ремень/цепь для крепления баллона (длина – 1м) – 1 шт.;
- Уголок для монтажа стойки к вертикальной поверхности (при поставке могут быть как установлены на стойку, так и упакованы отдельно) – 2 шт.;
- Паспорт изделия – 1 шт.

[1] Так же выпускаются модели ТДМ-СБМП-01 (стойка для 1 баллона) и ТДМ-СБМП-03 (стойка для 3 баллонов).

ООО "ТехноДизайн-М" Образец

4. Монтаж изделия.

Стойка устанавливается на подготовленное горизонтальное основание. Допустимое отклонение плоскости основания – не более 10 мм на весь выверяемый участок. Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на всей длине основания и местные неровности поверхности не должны превышать 3 мм.

Крепление стойки с помощью болтовых соединений должно быть осуществлено, как минимум, либо к горизонтальному основанию, либо к капитальной вертикальной конструкции (стене, колонне и т.п.).

Крепление к горизонтальному основанию осуществляется с помощью болтового или анкерного соединения. Крепление к горизонтальному основанию осуществляется через отверстия в профиле в основании стойки. Анкерные болты в комплект поставки не входят.

Крепление к вертикальной конструкции (стене, колонне и т.п.) осуществляется с помощью 2 уголков, входящих в комплект поставки.

При установке на стойку дополнительных универсальных баллонных адаптеров для баллонов от 5л до 10л ТДМ-АБУ-5-10, баллонный адаптер устанавливается на место ложемента, с использованием крепежных отверстий для ложементов в каркасе рамы.

Монтажную панель в верхней части баллонной стойки при необходимости можно снять со стойки или поднять выше. Подъём панели осуществляется с шагом смещения – 50 мм.

5. Установка баллонов.

Перед установкой баллона, выполнить проверку ремня (цепи) для крепления баллона на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений, провести замену поврежденного ремня (цепи).

Баллон установить в ложемент. Выполнить фиксацию баллона в ложементе с помощью ремня (цепи). Убедится, что баллон прочно закреплен.

6. Упаковка и транспортирование.

Упаковке подлежат составные части изделия перед транспортировкой или длительным хранением, которые:

- не имеют постоянного/штатного места крепления на изделии;
- не позволяют транспортировать изделие без демонтажа составной части;

Стойка упаковывается в защитную пленку и устанавливается на деревянный поддон.

Транспортирование изделия производится транспортом с соответствующими габаритам и массе стойки характеристиками. Габариты стойки приведены в Приложении А. Масса стойки указана в разделе «Технические характеристики» настоящего паспорта изделия. Погрузку и выгрузку установки выполнять краном или механическим подъёмником.

7. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, при соблюдении потребителем условий, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки. Срок службы составляет 5 лет.

8. Сведения об утилизации.

Стойка не имеет в своем составе ядовитых и токсичных компонентов. Перед непосредственной утилизацией необходимо осуществить подготовку:

ООО "ТехноДизайнМ" Образец

1. Отключить стойку от внешних трубных коммуникаций.
2. Осуществить демонтаж оборудования, установленного на стойку, с целью принятия решения об его использовании отдельно от стойки либо сортировке по виду материала для предстоящей утилизации. Утилизацию оборудования, не входящего в состав стойки, следует осуществлять с учётом требований по утилизации, указанным в эксплуатационной документации на него.

По результатам завершения подготовки провести мероприятия по утилизации стойки.

Процесс утилизации регламентируется нормативными актами и законами Российской Федерации, и местными документами на основании рекомендаций текущего руководства по эксплуатации и эксплуатационной документации на оборудование, смонтированное в шкафу.

9. Сведения о предприятии-изготовителе.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектация изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления.

Все пожелания по усовершенствованию следует направлять в адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Технодизайн-М»,
Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2,
т/ф +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28.
эл.почта: info@nice-device.ru,
сайт: www.nice-device.ru.

ООО "Технодизайн-М"
Образец

10. Свидетельство о приёмке.

Баллонная стойка для двух 40 (50) л. баллонов (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)

Заводской №_____

Модель: ТДМ-СБМП-02.

изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией по проекту ТДМ.ТДМ-СБМП-02.


Дата приёмки: МП.

Подпись лица, ответственного за приёмку _____ _____
подпись

11. Особые отметки.

ООО "Технодизайн-М"
Образец

Приложение А.

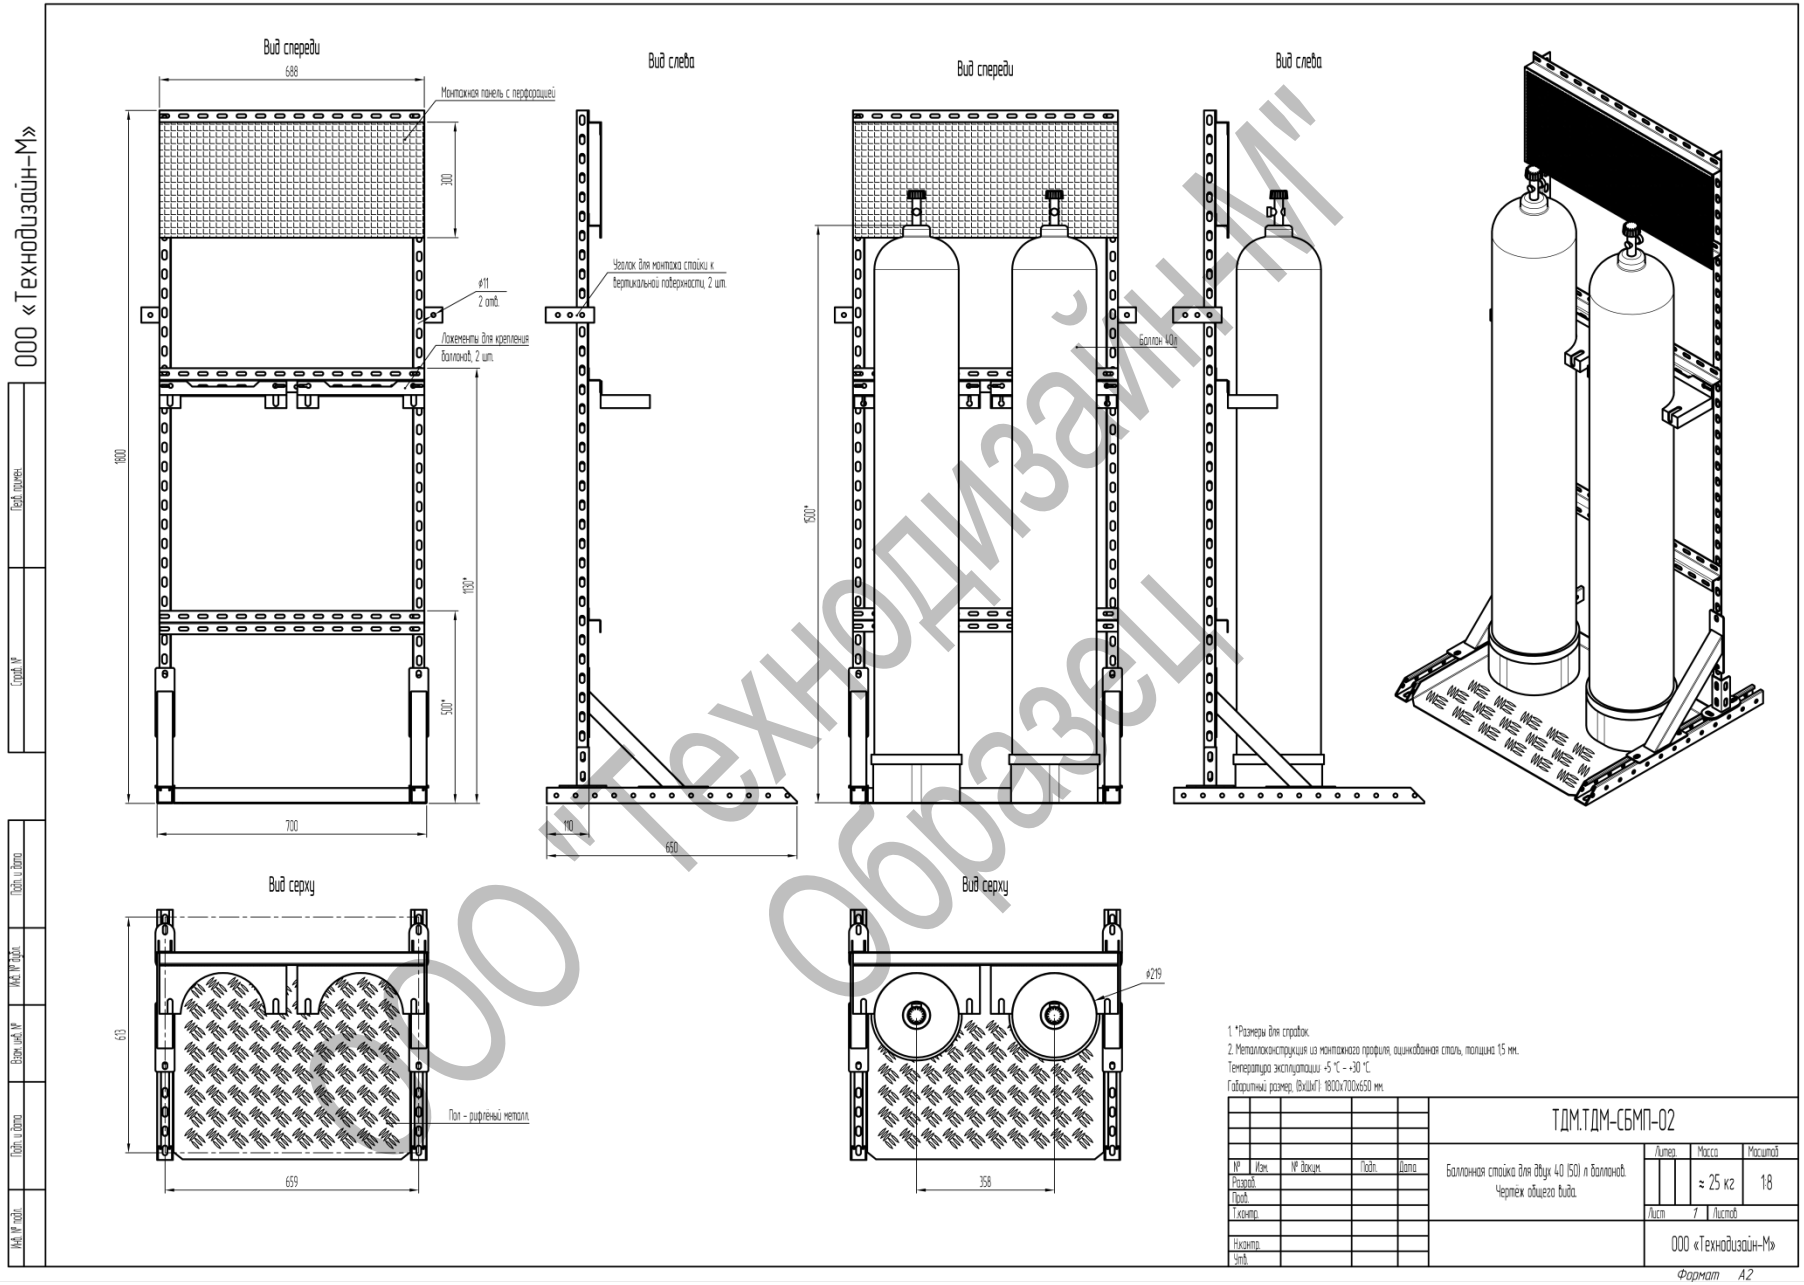

1. *Размеры для справок.
2. Металлоконструкция из монтажного профиля, оцинкованная сталь, толщина 15 мм.
Температура эксплуатации +5 °С – +30 °С.
Габаритный размер, (ВхШхГ) 1800х700х650 мм.

ООО "Технодизайн-М" Образец